


عقنل او غيرفتلا تحت تي لورتكل إلال ةئبعتل ةلماكتم ةلأ

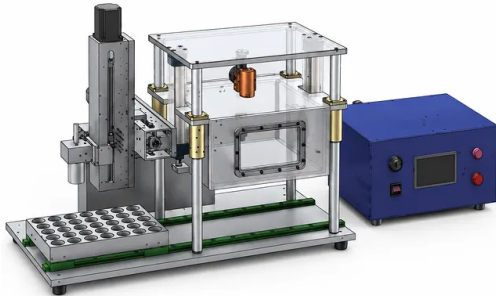

ةمدقم

تيلورث كلكل إلة عبعتل ةلم اكتمل ةلأل رفوت
 $\pm 0.5\%$ غلبت تا عرج ةقد عقنل او غي رفرتل تحت
 ةلم عمل او ةين اوطسأل تايراطبب اياي لخل
 جم ربم ل غي رفرتل نيب عمجت ثيح سايكأل او
 ةموكحم ل ةحارل او لم اخل زاغل اب عبعتل او
 يف تيلورث كلكل إلة صاصت ما قاستا نيسحتل
 ريسو ةمدقتل تايراطبب ل عي نصت تايلمل ع
 ةيرب تخم ل اءا بأل لم ع

ديزمل فرعا

[illegible][illegible]

هفصاومال	هفمقلا
هفنفلا هفسلا قاطن	لم 100 - لم 0.2
هفلللا تفلورلكلل هفبعت هفمك	مك 100 - مك 0.2
جارلل/هفزوتلا هفس	للدعتلل هلباق هفنا/لم 20-0.1
هفود لكلا هفناوطلال الالل	35
1 موعدملا هفناوطلال قفسننلا	عافترا مم 27 × جراح رطق مم 13
2 موعدملا هفناوطلال قفسننلا	عافترا مم 37 × جراح رطق مم 16
3 موعدملا هفناوطلال قفسننلا	عافترا مم 27 × جراح رطق مم 18
4 موعدملا هفناوطلال قفسننلا	عافترا مم 44 × جراح رطق مم 22
5 موعدملا هفناوطلال قفسننلا	عافترا مم 50 × جراح رطق مم 30
6 موعدملا هفناوطلال قفسننلا	عافترا مم 82 × جراح رطق مم 35
هفرحلا هفراال داوم	لكآلل مواقم 316 و 304 أذللل مواقم ذالوف
جرحملاو لخدملا لفسوت	هفئاهفمكلا لكآلل هفمواقم هفنرم بففانأ
مكحتلا ماطن	سمللاب لمغت هفشاشو PLC لفلغشت
هفتمألا	هفنرم تاملمعم عم هفلألا هفجمربلا نم هفللاغ هفجرد
تفبثتلا عقوم	هفاج هفرغ وأ تازافق قوونص
هفطفملا هفراال هفجرد تابلطتم	للفمعل اعنصم هفئاهفمك
هفاطلا رصم تابلطتم	10%- إلى 10%+ :هفجال ببذت قاطن ؛زتره 50 ،تلفوف 220
نوكملا هفاطلا رصم	AC220V/50Hz/1KW
طوغضملا هفاوه تابلطتم	2م/س/مك 4.0 نم ربكأ جرحملا طغض ؛طغضلا مطنم ورتلفم و ففجم هفاوه
تازافقلا قوونص طوغضملا زاعلا تابلطتم	تازافقلا قوونص لخد دوجوملا زاعلا عم"افاوتم مءختسملا زاعلا نوكف نأ بءف
هفرففلا رصم تابلطتم	(للفأ وأ لالكساب ولفك 98-) بففانألا طخ هفرفف وأ ؛للفأ وأ لالكساب ولفك 98- ،هفنا/رتل 2 هفرفف هفضم
هفسفئرلا هلالا داغأ	مم 640 عافترا × مم 450 ضرع × مم 900 لوط
مكحتلا قوونص داغأ	مم 255 عافترا × مم 420 ضرع × مم 450 لوط
نزولا	مك 180